

pipetty クイックガイド

本体



「PUSHボタン」と「バックボタン」はどちらを押しても吸入／吐出が可能です

LCD表示内容

バッテリーインジケーター

モード

- S(シングル)モード**定量分注、ミキシング
- M(マルチ)モード**等量連続分注
- SC(シングルキャリブレーション)モード** ...Sモード校正
- MC(マルチキャリブレーション)モード** ...Mモード校正
- SEL(セレクト)モード**速度・音設定


吐出量

ミキシング量または吐出回数


START(分注開始可能時に点灯)

操作例

S(シングル)モード

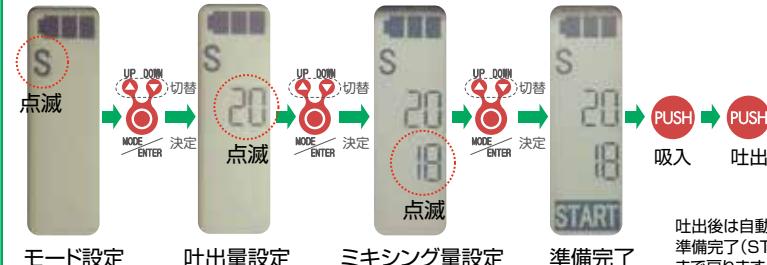

M(マルチ)モード

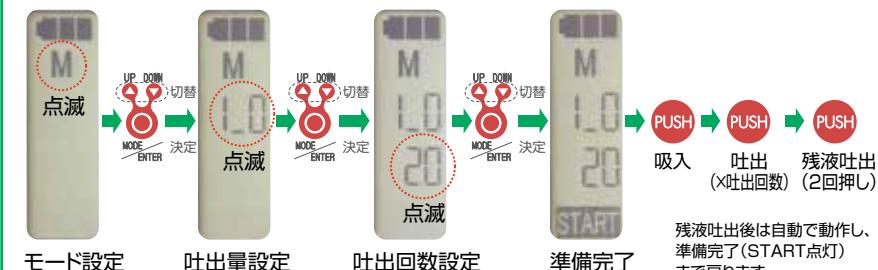

SEL(セレクト)モード



この取扱説明書は本体用クイックガイドです。

詳しい操作方法については本体用取扱説明書をご覧下さい。

本体用取扱説明書、アプリケーション用取扱説明書、アプリケーションソフトウェアは、弊社ホームページよりダウンロード出来ます。

URL <http://www.icomes.co.jp>



製造元 株式会社アイカムス・ラボ
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡一丁目8番25号
TEL 019-601-8228 FAX 019-601-8227